



## Πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Περιγραφή του προϊόντος:</b>  | Optitrol NAT HCV Screening   |
| <b>Αριθμός καταλόγου:</b>        | NT01022  |
| <b>Παρτίδα:</b>                  | 10816888 (Κουτί)<br>10816887 (Φιαλίδιο)  |
| <b>Ημερομηνία λήξης:</b>         | 29 Φεβ 2028  |
| <b>Εφαρμογή:</b>                 | Για <i>in vitro</i> διαγνωστική χρήση  |
| <b>Φύλαξη:</b>                   | -20 °C έως -40 °C  |
| <b>Ανθρώπινος ιικός δείκτης:</b> | Οι μάρτυρες παρασκευάζονται από επεξεργασμένο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό θετικό για RNA του HCV.<br>Τα υλικά αποθέματος HCV αδρανοποιήθηκαν με ακτινοβολία γάμμα.  |
| <b>CE 2797:</b>                  | Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται και διανέμεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα <i>in vitro</i> διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. |
| <b>Αποδέσμευση παρτίδας:</b>     | Η παρτίδα έχει ελεγχθεί σύμφωνα με έγκυρες οδηγίες. Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια προδιαγραφών και αποδεσμεύτηκε προς πώληση.   |

**Έγκριση:**

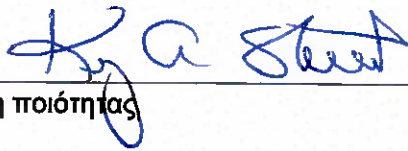

Διασφάλιση ποιότητας

  
23 Jun 2026

Ημερομηνία