

Certificato di Controllo qualità

Descrizione del prodotto: Optitrol NAT HCV Screening

Numero di catalogo: NT01022

Lotto: 10816888 (scatola)

10816887 (fiala)

Data di scadenza: 29 Feb. 2028

Applicazione: Per uso diagnostico *in vitro*

Conservazione: Da -20 °C a -40 °C

Marcatore virale umano: I controlli sono preparati a partire da plasma o siero umano trattato positivo per l'RNA dell'HCV.

I materiali in stock di HCV sono stati inattivati mediante radiazioni gamma.

CE 2797:


Questo prodotto è fabbricato e distribuito in conformità del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Rilascio lotto:

Il lotto è stato testato secondo modalità valide. Soddisfa tutti i criteri di specifica richiesti ed è stato rilasciato per la vendita.

Approvazione:

Verifica della qualità

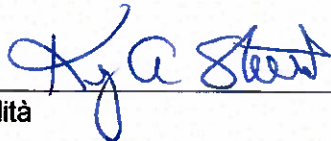

Data

03 JUN 2026